

BASICLIFESUPPORT 2025

1 PRÜFEN

- ▶ Ansprechen
- ▶ Berühren
- ▶ Sanftes Schütteln an den Schultern



2 ATEMWEGE ÖFFNEN



3 ATEMWEG KONTROLIEREN

Sehen, Hören, Fühlen
maximal 10 Sekunden

4 NOTRUF 144



5 + 9

30x HERZDRUCKMASSAGE UND 2x BEATMUNG

Falls Sie nicht trainiert oder im Stande sind zu beatmen, führen Sie (nur) die Thoraxkompressionen fort.
(100 -120x pro Minute)

DEFIBRILLATOR EINSETZEN



DEFIBRILLATOR EINSETZEN

6 GERÄT EINSCHALTEN




Den Anweisungen des Geräts folgen

7 ELEKTRODEN AUFKLEBEN



8 SCHOCK ABGEBEN

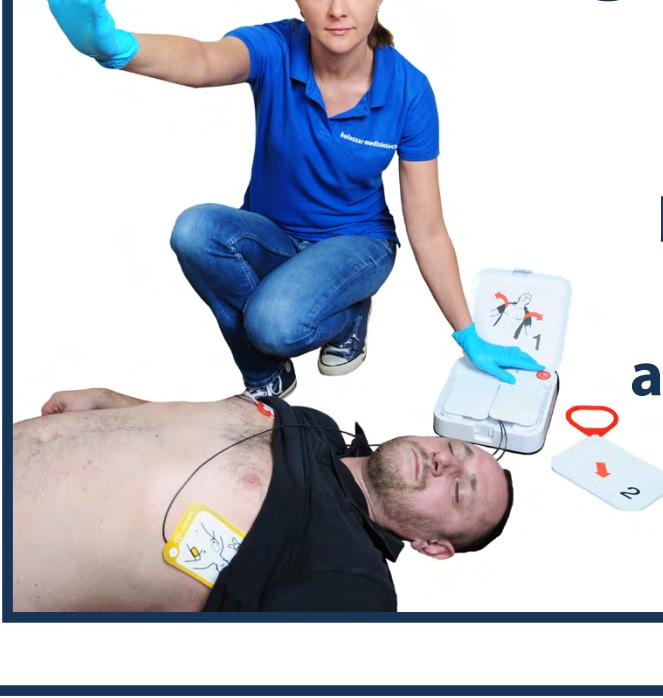

Patienten nicht berühren, wenn ein Schock abgegeben wird!



Folgen Sie uns auf:



@koloszar.medizintechnik




@koloszar_medizintechnik



@koloszar-medizintechnik-gmbh



koloszar.letscast.fm



Stefan Koloszar
Geschäftsführer
s.koloszar@koloszar.at



Marco Sodomka
Prokurist & Vertriebsleiter
m.sodomka@koloszar.at

Koloszar Medizintechnik GmbH
Siegfried Theiss-Straße 11
2700 Wiener Neustadt

www.koloszar.at
office@koloszar.at
+43 26 22 86 101 DW 21